



Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Page
Seite 1 / 2

Customer:
Kunde: TECHNOM TOOLS B.V.
Bedrijventerrein "Seyst"
Woudenbergseweg 19-C6
NL 3707 HW ZEIST

Certificate No.
Zeugnis-Nr. 00374752

Date
Datum 09.07.2018

Customer Order No.
Kundenbestellnummer 11840074

Customer Part. No.
Kunden Artikel-Nr. KD09.00400C

Order Date
Bestelldatum 29.06.2018

Order No. / Item
Auftrags-Nr. / Pos. SO00333778/4

Part No.
Artikel-Nr. 47436789

Model
Typ 233.50

Scale range
Anzeigebereich 0 ... 40 bar rel.

Serial number
Seriennummer 8970N5GQ

Class
Klasse 1,00 %

Tag No.
Messstellen-Nr. KSC157

Reference
Referenzgerät CPG2500 0,01% IS-50 0 ... 400 bar rel.


Calibration No.
Kalibriernummer 03409687 DKD 18-01

Result

Temperature
Temperatur 20°C +/- 5 K

Ergebnis

Test Item Prüfung bar	Standard Referenz bar		Meanvalue Mittelwert bar	rel. Deviation rel. Abweichung bar	Deviation Abweichung %	Hysteresis Hysterese %
	↑	↓				
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
10,000	9,789	10,135	9,962	0,038	0,09	0,87
20,000	19,874	20,219	20,046	-0,046	-0,12	0,86
30,000	29,881	30,167	30,024	-0,024	-0,06	0,71
40,000	39,706	39,706	39,706	0,294	0,74	0,00

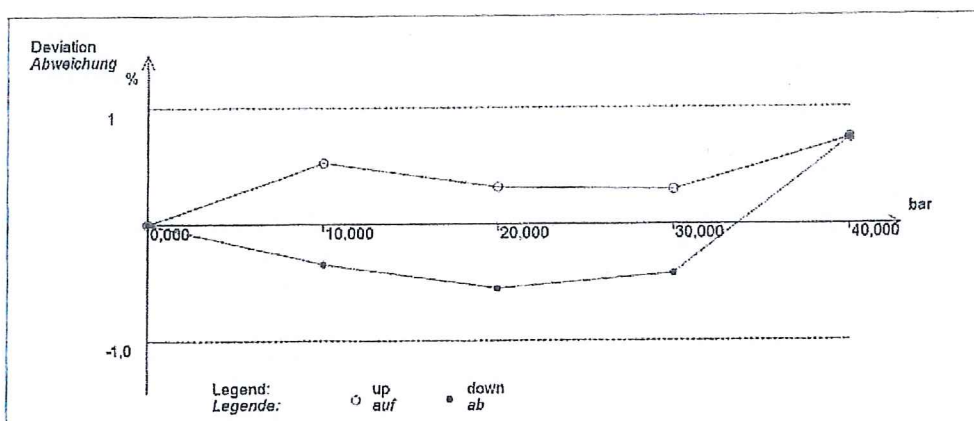

WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Kilgenberg
Germany

Phone: +49 9372 132/0
Fax Inland: +49 9372 132/406
E-Mail: info@wika.de
Internet: www.wika.de



Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Page
Seite 2 / 2

Customer:
Kunde: TECHNOM TOOLS B.V.
Bedrijventerrein "Seyst"
Woudenbergseweg 19-C6
NL 3707 HW ZEIST

Certificate No.
Zeugnis-Nr. 00374752

Date
Datum 09.07.2018

Object keeps the specification.

Der Kalibriergegenstand hält die Fehlergrenzen nach Herstellerangaben ein.

Calibration was carried out according to the following norm:

DIN EN 837-1

Die Kalibrierung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:

Remarks / Bemerkung:

Inspection Representative
Abnahmebeauftragter (PI-PG)
Ralf Gross

Examiner
Prüfer K.Kwiatkowska

This document was created automatically and needs no signature.

Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und gilt ohne Unterschrift.